


Bague d'étanchéité pour réservoir de chaux respirable Dräger, 2 joints sont

...

Numéro d'article: 1004885

18,00 €
prix net

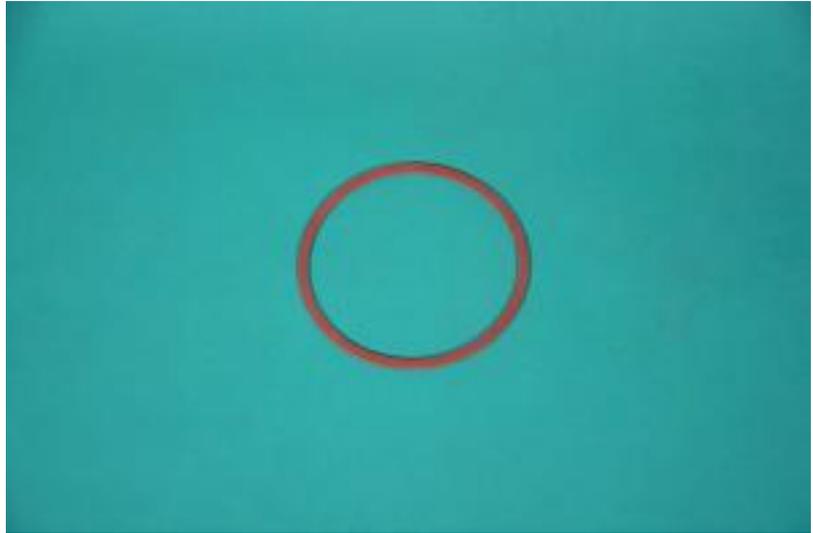

Product description

Bague d'étanchéité pour réservoir de chaux respirable Dräger, 2 joints sont nécessaires pour le réservoir de chaux respirable (1x en haut, 1x en bas), NOUVEAU ATTENTION : Cette pièce n'est PAS une pièce d'origine DRÄGER et ne doit être utilisée qu'en médecine vétérinaire.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

